


拭き取り試験データ

消毒用エタノール

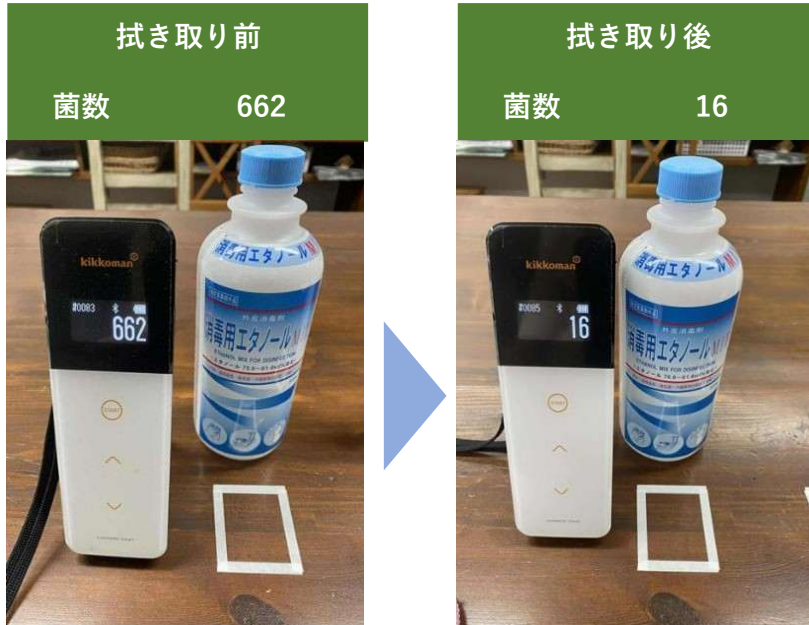

【97.6%減】

manw



【99.2%減】

※拭き取りによる除菌テストを実施（消毒用エタノールと比較）

※マスキングテープで囲った領域の雑菌量を拭き取り前・拭き取り後で測定

測定器【kikkoman Lumitester Smart（キッコーマン社製）ATP拭き取り検査用 A3 Surfac】